

# SZM A ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK



**BC. LENKA SÜSSOVÁ**


Výsledky hodnocení VZ Inkontinence

2022




# VZ INKONTINENCE

- Poslední VZ Inkontinence spojená s kosmetikou 2015
- Celkem za rok 6 500 000 mil/Kč
- VZ na 4 roky – 2022 - 2026
- Poměr Kvalita x Cena – 20% x 80%
- Nová změna specifikace
- Nový způsob testování vzorků Komise x ZOK

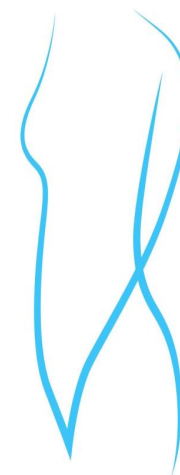

# PŘEDMĚT ZAKÁZKY

- Jednorázové plenkové kalhotky dětské
- Jednorázové plenkové kalhotky dospělé
- Podložky pro nemocné
- Vložné pleny
- Mycí žínky
- Gynekologické vložky
- Kosmetika

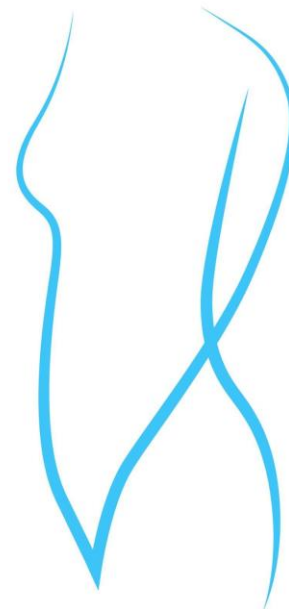

# ZPŮSOB TESTOVÁNÍ - KOMISE I

- Test komise ( např. Jednorázové plenky pro dospělé )
- **Funkčnost savého jádra**
- *„test bude proveden komisí určenou pro veřejnou zakázku a to tím způsobem, že bude tekutina postupně nalévána na plenu v min. množství a v maximálním množství uvedených v technickém listě doporučeném na savost. Kontrolovaná bude horní hranice savosti. Povrchová vlhkost bude testována přiložením savého papíru, prověření indikátoru vlhkosti – detenční proužek je zbarvený, obsah pleny je naplněn“*
- **Prodyšnost a nešustivost materiálu**
- *„test bude proveden komisí určenou pro veřejnou zakázku a to tím způsobem, že bude zkoumán dotyk a smýkání plenou po podložce. Prodyšnost materiálu bude ověřena profouknutím materiálu.“*

# ZPŮSOB TESTOVÁNÍ - KOMISE II

- **Suché zipy nebo lepítka**
- *„test bude proveden komisí určenou pro veřejnou zakázku s tím, že několikrát provede manipulaci upínáním kdekoliv na plenkových kalhotkách“*
- **Kvalita materiálu, celkové provedení výrobku, balení výrobku**
- *„test bude proveden komisí určenou pro veřejnou zakázku tím, že bude sledována celková kvalita materiálu v tahu, pohledem na materiál a zřetel bude brát na balení, ve kterém jsou kalhotky.“*

# ZPŮSOB TESTOVÁNÍ - ZOK I

- **Test ZOK ( např. Jednorázové plenky pro dospělé )**
- **Funkčnost savého jádra**
- *„test bude proveden v provozu určeném komisí na příslušném oddělení, kde budou plenkové kalhotky nasazeny, novorozencům, nebo větším dětem, na ostatních lůžkových stanicích i dospělým. Po použití bude testováno lůžko a pokožka zda jsou suché, dále pak celistvost plen po použití (nesmí se drodit), prověřen bude indikátor vlhkosti, zda je funkční, pacient nemá žádné známky kožních projevů ve smyslu alergie*
- **Prodyšnost a nešustivost materiálu**
- *„test bude proveden na příslušných odděleních tak, že bude ověřeno, zda materiál při dotyku s lůžkem šustí a prodyšnost bude ověřena tím, že pokožka nebude po sejmutí pleny zarudnutá a zapařená. Pozitivní výsledek testu materiálu je, že materiál nevydává šustivé zvuky a proud vzduchu prochází přes prodyšnou část materiálu u ležících není pokožka zarudlá, žádná kožní reakce“*

# ZPŮSOB TESTOVÁNÍ - ZOK II

- **Suché zipy nebo lepítka**
- *„test bude proveden v provozu s tím, že bude několikrát prověřeno, zda jde suchý zip nebo lepítko znovu připevnit ke kalhotkám zda se samovolně neodlepí a zda při manipulaci není plena natržena, při manipulaci s pacientem se lepítko nebo zip nesmí přilepit k lůžku, nebo k pacientovi“*
- **Kvalita materiálu, celkové provedení výrobku, balení výrobku**
- *„test bude proveden i na příslušném oddělení dle zkušenosti odborníků, zda je materiál na pohmat vyhovující, balení jestli je dostačující“*

# DODAVATELÉ – PODÁNÍ NABÍDEK

- ESSITY CZECH
- HARTMAN RICO a.s.
- MSM spol. s.r.o.
- TZMO CZECH Republic s.r.o.
- BATIST Medical a.s.
- Perfekt Distribution a.s.
- Black Storm s.r.o.
- Medisun profi s.r.o.



# PRACOVNÍŠTĚ FN - VZORKY

- Chirurgická klinika
- I. Interní klinika
- Interní oddělení
- Geriatrie
- Urologie
- Pobytová sociální péče 2
- Neonatologie
- Dětská klinika
- Gynekologicko – porodnická klinika
- Centrální sterilizace
- **Garantem testování je vrchní a staniční sestra příslušného ZOK**

# VZORKY K ROZDĚLENÍ



# PŘÍKLAD NESPRÁVNÉHO KLEPNUTÍ S PLENOU



Skenováno pomocí CamScanner



# HODNOCENÍ NABÍDEK - KRITÉRIA

- Nabídková cena váha 80% - číselně vyjádřitelné kritérium
- Kvalitativní úroveň 20% - číselně nevyjádřitelné kritérium na základě provedeného testování komise a ZOK
  
- **Vzorky získaly počet bodů dle průměru přiděleného jednotlivými testujícími dle bodové stupnice**
- **100 bodů** – výborný vzorek, úplné naplnění kvality
- **80-99 bodů** – velmi dobrý vzorek, není námitek k jeho použití, zanedbatelné nedostatky
- **50-79 bodů** – dobrý vzorek, drobné nedostatky
- **10-49 bodů** – přijatelný vzorek, nedostatky závažné
- **0 bodů** – nepřijatelný vzorek, nesplnění technické specifikace

# POŽADAVKY NA SAVOST - PLENKY

- V zadávací dokumentaci u každé části požadavek na velikosti i savost
- Ověřeno komisí z technických a specifikačních listů od výrobce
- Ověřeno testem komise – nalévání vody v doporučeném a předepsaném množství

## **Příklad:**

- **Jednorázové plenkové kalhotky pro dospělé – těžká inkontinence:**
- Požadavek:
- M – obvod těla (80-115 cm) tolerance 5 cm minimální garantovaná absorpční savost 2200 ml
- L – obvod těla (115-150 cm) tolerance 5 cm minimální garantovaná absorpční savost 2400 ml
- XL – obvod těla (150-170 cm) tolerance 5 cm minimální garantovaná absorpční savost 2700ml

# VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ - KOMISE

## TEST KOMISE

| 2.1. Jednorázové plenkové kalhotky pro dospělé - střední inkontinence  | Funžnost svého jádra   | Prodyšnost a nešustivost | Funžnost suchých zipů/lepítek                 | Kvalita materiálu a celkové provedení                          | ks/vzorku  |
|--|--|--------------------------|---|--|------------|
| <b>Essity Czech</b><br>Tena Slip super S - obvod 56-85cm savost 1697 ml<br>Tena Slip plus M - obvod 73-122cm savost 2160 ml<br>Tena slip plus L - obvod 92-144cm savost 2360 ml<br>Tena Slip super XL - obvod 110 - 160cm savost 3187 ml   | nejlepší absorber<br>savý papír suchý<br>dobře se polevobí<br>indikátor je vidět<br>100b               | řeškové<br>100b          | v pase líkat odlepilo<br>dle pybnosti<br>100b | 100b   | 100b       |
| <b>HARTMAN-RICO a.s.</b><br>MoliCare Elastic 6 kapek S - obvod 70-90cm savost 1667 ml<br>MoliCare Elastic 6 kapek M - obvod 85-120cm savost 2159 ml<br>MoliCare Elastic 6 kapek L - obvod 115-145cm savost 2349 ml<br>MoliCare Elastic 6 kapek XL - obvod 140 - 175cm savost 2786 ml | absorber jádro<br>je zrušeno, no hrady<br>savý papír mokry<br>moždava horší u vlhka<br>50b             | rušivé<br>100b           | lepka ok<br>100b                              | indikátor vlhkost<br>není vůbec vidět<br>mokry stří<br>80b 40b | 80b<br>80b |
| <b>MSM spol s.r.o.</b><br>ATTENS Slip Regular 9 S - obvod 50-80cm savost 1750 ml<br>ATTENS Slip Regular 8 M - obvod 80-110cm savost 2099 ml<br>ATTENS Slip Regular 8 L - obvod 100 - 150cm savost 2499 ml<br>ATTENS Slip Regular 10 XL - obvod 150 - 175cm savost 3260 ml            | abs. jádro s tkvěte<br>papír, mlree<br>mokry lény papír<br>95b   | 100b                     | 100b  | indikátor v řetě<br>je přizomen,<br>mokry stříny<br>95 bodů    | 97,5       |
| <b>IZMO Czech Republic s.r.o.</b><br>iENI Classic S - obvod 55-80cm savost 1600 ml<br>iENI Classic HE M - obvod 75-110cm savost 1930ml<br>iENI Classic HE L - obvod 100 - 150cm savost 2284 ml<br>iENI Classic Plus HE XL - obvod 130 - 170cm savost 2700 ml                         | při polevobí polevka<br>100ml voda stěka<br>po pleu, kapky na<br>povrchu, teče jí a<br>nafoukne<br>90b | 100b                     | ok<br>100b                                    | indikátor je<br>málo vidět<br>92b                              | 96,5       |

- 100 bodů – výborný vzorek, úplné naplnění kvality,
- 80-99 bodů – velmi dobrý vzorek, není námitek k jeho použití,
- 50 - 79 bodů – dobrý vzorek, drobné nedostatky,
- 10 - 49 bodů – přijatelný vzorek, nedostatky závažné,
- 0 bodů – nepřijatelný vzorek, nesplnění technické specifikace.

Pokud má výrobek jakékoliv nedostatky anebo snižujete bodové hodnocení, popište je krátce

Vyplněné vraťte zpět na odd SZM - vedoucí odd Bc. Lenka Pletichová

Fakultní nemocnice Plzeň  
 vedoucí Oddělení  
 nákupu a distribuce SZM  
 Bc. Lenka Pletichová

*Plzeň /*

# VÝSLEDEK TESTU KOMISE – ESSITY CZECH



# VÝSLEDEK TESTU KOMISE – HARTMAN RICO





# VÝSLEDEK TESTU KOMISE – MSM SPOL S.R.O.



# VÝSLEDEK TESTU KOMISE – TZMO CZECH REPUBLIC



# TESTOVÁNÍ – ZOK PSP2

Bc. VANÍČKOVÁ TEREZA - PSP 2

| 2.1 Jednorázové plenkové kalhotky pro dospělé - střední inkontinence   | Funčnost svého Jádra | Prodyšnost a nešustivost  | Funčnost suchých zipů/lepítek          | Kvalita materiálu a celkové provedení | ks/vzorku                        |
|--|----------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Essity Czech</b><br>Tena Slip super S - obvod 56-85cm savost 1697 ml<br>Tena Slip plus M - obvod 73-122cm savost 2160 ml<br>Tena slip plus L - obvod 92-144cm savost 2360 ml<br>Tena Slip super XL - obvod 110 - 160cm savost 3187 ml   | > 70 b               | Musí savost, materiál prodyšný<br>musí rozmezí, jemný šetrný                                    |  |                                       | 1 bal<br>1 bal<br>1 bal<br>1 bal |
| <b>HARTMAN-RICO a.s.</b><br>MoliCare Elastic 6 kapek S - obvod 70-90cm savost 1667 ml<br>MoliCare Elastic 6 kapek M - obvod 85-120cm savost 2159 ml<br>MoliCare Elastic 6 kapek L - obvod 115-145cm savost 2349 ml<br>MoliCare Elastic 6 kapek XL - obvod 140 - 175cm savost 2786 ml | > 85 b               | malé rozměry, savost dobrá<br>- <del>prodyšnost</del> dobrý materiál, prodyšný<br>- musí savost |  |                                       | 1 bal<br>1 bal<br>1 bal<br>1 bal |
| <b>MSM spol s.r.o.</b><br>ATTENS Slip Regular 9 S - obvod 50-80cm savost 1750 ml<br>ATTENS Slip Regular 8 M - obvod 80-110cm savost 2099 ml<br>ATTENS Slip Regular 8 L - obvod 100 - 150cm savost 2499 ml<br>ATTENS Slip Regular 10 XL - obvod 150 - 175cm savost 3260 ml            | > 85 b               | pro nás nepřijatelné -<br>- bílá šev, materiál  | malé rozměry, savost dobrá<br>prodyšný |                                       | 1 bal<br>1 bal<br>1 bal<br>1 bal |
| <b>TZMO Czech Republic s.r.o.</b><br>SENI Classic S - obvod 55-80cm savost 1600 ml<br>SENI Classic HE M - obvod 75-110cm savost 1930ml<br>SENI Classic HE L - obvod 100 - 150cm savost 2284 ml<br>SENI Classic Plus HE XL - obvod 130 - 170cm savost 2700 ml                         |                      |   |  |                                       |                                  |

> 4 bal

> 4 bal

> 4 bal

- 100 bodů – výborný vzorek, úplné naplnění kvality,
- 80-99 bodů – velmi dobrý vzorek, není námitek k jeho použití, zanedbatelné nedostatky,
- 50 - 79 bodů – dobrý vzorek, drobné nedostatky,
- 10 - 49 bodů – přijatelný vzorek, nedostatky závažné,
- 0 bodů – nepřijatelný vzorek, nesplnění technické specifikace.

Pokud má výrobek jakékoliv nedostatky anebo snižujete bodové hodnocení, popište je krátce

Vyplněné vraťte zpět na odd SZM - vedoucí odd Bc. Lenka Pletichová

Fakultní nemocnice Plzeň  
vedoucí Oddělení  
nákupu a distribuce SZM  
Bc. Lenka Pletichová

*Pletichová*

# VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ CELKOVĚ – ZOK X KOMISE

## VZ - Inkontinence 2021

| 2.1 Jednorázové plenkové kalhotky pro dospělé - střední inkontinence | Funkčnost svého jádra   | Prodyšnost a nešustivost   | Funkčnost suchých zipů/lepítek  | Kvalita materiálu a celkové provedení výrobku                                 | Celkové hodnocení/stani ce   | celkem bodů na položku | Komentář hodnocení méně než 100 bodů  | pořadí ve skupině |
|--|---|--|---|---|--|------------------------|---|-------------------|
| <b>Essity Czech Republic, s.r.o.</b>                                 | CHIR 100 bodů<br>GERI 100 bodů<br>KOM 100 bodů<br>PSP2 70 bodů<br>1IK 50 bodů | CHIR 95 bodů<br>GERI 100 bodů<br>KOM 100 bodů<br>PSP2 70 bodů<br>1IK 50 bodů   | CHIR 95 bodů<br>GERI 100 bodů<br>KOM 100 bodů<br>PSP2 70 bodů<br>1IK 50 bodů  | CHIR 100 bodů<br>GERI 100 bodů<br>KOM 100 bodů<br>PSP2 70 bodů<br>1IK 50 bodů | CHIR 98 bodů<br>GERI 100 bodů<br>KOM 100 bodů<br>PSP2 70 bodů<br>1IK 50 bodů | <b>84,00</b>           | PSP2 - gumíčky škrtili, menší savost, menší rozměr<br>1IK - málo savé, nepohodlné pro pacienta, nedrží lepitka, tvrdý materiál  | <b>2</b>          |
| <b>HARTMANN-RICO, a.s.</b>   | CHIR 85 bodů<br>KOM 50 bodů<br>INTO 100 bodů<br>PSP2 85 bodů<br>1IK 100 bodů  | CHIR 100 bodů<br>KOM 100 bodů<br>INTO 100 bodů<br>PSP2 85 bodů<br>1IK 100 bodů | CHIR 100 bodů<br>KOM 100 bodů<br>INTO 100 bodů<br>PSP 85 bodů<br>1IK 100 bodů | CHIR 100 bodů<br>KOM 70 bodů<br>INTO 100 bodů<br>PSP2 85 bodů<br>1IK 100 bodů | CHIR 96 bodů<br>KOM 80 bodů<br>INTO 100 bodů<br>PSP2 85 bodů<br>1IK 100 bodů | <b>92,00</b>           | PSP2 - není savost<br>KOM - absorpční jádro se změní na hrůdky a mazlavou hmotu, mokřý savý papír, indikátor vlhkostizměl   | <b>1</b>          |
| <b>MSM, spol. s.r.o.</b>   | KOM 95 bodů<br>INTO 60 bodů<br>PSP2 85 bodů<br>1IK 70 bodů<br>URO 85 bodů     | KOM 100 bodů<br>INTO 60 bodů<br>PSP2 85 bodů<br>1IK 70 bodů<br>URO 85 bodů     | KOM 100 bodů<br>INTO 60 bodů<br>PSP2 85 bodů<br>1IK 70 bodů<br>URO 85 bodů    | KOM 95 bodů<br>INTO 60 bodů<br>PSP2 85 bodů<br>1IK 70 bodů<br>URO 85 bodů     | KOM 98 bodů<br>INTO 60 bodů<br>PSP2 85 bodů<br>1IK 70 bodů<br>URO 85 bodů    | <b>80,00</b>           | INTO - pomalé vsakování - vlhký pacient, lepší se na pokožku, po opakovaném zalepení nedrží, mručňají se<br>PSP2 - malé rozměry, dobrá savost<br>1IK - snížená savost, žustí, nedrží při opakovaném lepení<br>URO - snížená savost, méně příjemný materiál oproti jinému vzorku | <b>4</b>          |
| <b>TZMO Czech Republic, s.r.o.</b>                                   | CHIR 95 bodů<br>GERI 70 bodů<br>KOM 90 bodů<br>1IK 50 bodů<br>URO 95 bodů     | CHIR 95 bodů<br>GERI 80 bodů<br>KOM 100 bodů<br>1IK 55 bodů<br>URO 95 bodů     | CHIR 95 bodů<br>GERI 80 bodů<br>KOM 100 bodů<br>1IK 55 bodů<br>URO 95 bodů    | CHIR 95 bodů<br>GERI 70 bodů<br>KOM 97 bodů<br>1IK 55 bodů<br>URO 95 bodů     | CHIR 95 bodů<br>GERI 75 bodů<br>KOM 97 bodů<br>1IK 54 bodů<br>URO 95 bodů    | <b>83,00</b>           | 1IK - snížená savost, nepodajný materiál, nedrží lepitka<br>GERI - výrazně horší fce svého jádra  | <b>3</b>          |

CHIR - Mgr. Šimandlová  
GERI - Mgr. Doležal  
KOM - Pietichová  
PSP2 - Bc. Vaníčková  
1IK - Mgr. Galušková  
INTO - Mgr. Čadová  
URO - Mgr. Kožíšková

### ZPŮSOB HODNOCENÍ

100 bodů - výborný vzorek, úplné naplnění kvality  
80-99 bodů - velmi dobrý vzorek, není námitek k jeho použití, zanedbatelné nedostatky  
50 - 79 bodů - dobrý vzorek, drobné nedostatky  
10 - 49 bodů - přijatelný vzorek, nedostatky závažné  
0 bodů - nepřijatelný vzorek, nesplnění technické specifikace.

## BODOVÉ HODNOCENÍ ČÁSTI 2 – JEDNORÁZOVÉ PLENKY PRO DOSPĚLÉ KVALITATIVNÍ ÚROVEŇ (NEČÍSELNÉ KRITÉRIA)

| nabídka číslo                        | 3                             | 7                  | 13                | 18                           |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| skupina/účastník                     | Essity Czech Republic, s.r.o. | HARTMANN-RICO, a.s | MSM, spol. s.r.o. | TZMO, Czech Republic, s.r.o. |
| 2.1<br>Střední inkontinence          | <b>91</b>                     | <b>100</b>         | <b>87</b>         | <b>90</b>                    |
| 2.2<br>Těžká inkontinence            | <b>91</b>                     | <b>100</b>         | <b>92</b>         | <b>79</b>                    |
| 2.4<br>Kalhotky pro mobilní pacienty | <b>100</b>                    | <b>84</b>          | <b>92</b>         | <b>93</b>                    |

## BODOVÉ HODNOCENÍ ČÁSTI 2 – JEDNORÁZOVÉ PLENKY PRO DOSPĚLÉ CELKOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ

| nabídka číslo                        | 3                             | 7                  | 13                 | 18                           |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| skupina/účastník                     | Essity Czech Republic, s.r.o. | HARTMANN-RICO, a.s | MSM, spol. s.r.o.  | TZMO, Czech Republic, s.r.o. |
| 2.1<br>Střední inkontinence          | <b>95,94609375</b>            | <b>69,42705021</b> | <b>78,63100803</b> | <b>98</b>                    |
| 2.2<br>Těžká inkontinence            | <b>98,2</b>                   | <b>67,66582055</b> | <b>81,3446115</b>  | <b>92,40587235</b>           |
| 2.4<br>Kalhotky pro mobilní pacienty | <b>100</b>                    | <b>70,41417214</b> | <b>76,2982741</b>  | <b>70,79513586</b>           |

## CELKOVÉ POŘADÍ NABÍDEK V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH

| nabídka číslo                        | 3                             | 7                  | 13                | 18                           |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| skupina/účastník                     | Essity Czech Republic, s.r.o. | HARTMANN-RICO, a.s | MSM, spol. s.r.o. | TZMO, Czech Republic, s.r.o. |
| 2.1<br>Střední inkontinence          | <b>2</b>                      | <b>4</b>           | <b>3</b>          | <b>1</b>                     |
| 2.2<br>Těžká inkontinence            | <b>1</b>                      | <b>4</b>           | <b>3</b>          | <b>2</b>                     |
| 2.4<br>Kalhotky pro mobilní pacienty | <b>1</b>                      | <b>4</b>           | <b>2</b>          | <b>3</b>                     |

## CELKOVÉ POŘADÍ NABÍDEK PO AUKCI

| nabídka číslo                        | 3                             |              | 7                  |              | 13                |             | 18                           |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------|
| skupina/účastník                     | Essity Czech Republic, s.r.o. |              | HARTMANN-RICO, a.s |              | MSM, spol. s.r.o. |             | TZMO, Czech Republic, s.r.o. |            |
| 2.1<br>Střední inkontinence          | <b>3</b>                      | <b>91 B</b>  | <b>2</b>           | <b>100 B</b> | <b>4</b>          | <b>87 B</b> | <b>1</b>                     | <b>90B</b> |
| 2.2<br>těžká inkontinence            | <b>1</b>                      | <b>91 B</b>  | <b>2</b>           | <b>100 B</b> | <b>4</b>          | <b>92B</b>  | <b>3</b>                     | <b>79B</b> |
| 2.4<br>Kalhotky pro mobilní pacienty | <b>1</b>                      | <b>100 B</b> | <b>2</b>           | <b>84 B</b>  | <b>3</b>          | <b>92B</b>  | <b>4</b>                     | <b>93B</b> |



## POŽADAVKY NA SAVOST – PODLOŽKY POD NEMOCNÉ

- V zadávací dokumentaci u každé části požadavek na rozměry a savost
- Ověřeno komisí z technických a specifikačních listů od výrobce
- Ověřeno testem komise – nalévání vody v doporučeném a předepsaném množství

### Příklad:

- **Podložky pod nemocné 60x90**
- Požadavek:
- Minimální garantovaná absorpční savost 1100 ml

# ZAJÍMAVOSTI – TEST PODLOŽEK BATIST MEDICAL



# ZAJÍMAVOSTI – TEST PODLOŽEK - MSM



# ZAJÍMAVOSTI – TEST PODLOŽEK HARTMAN RICO



# ZÁVĚR – VÝHODY A NEVÝHODY TESTOVÁNÍ

## Výhody:

- Ověření kvality materiálu 2 fázovým testováním komise x ZOK
- Spokojenost ZOK s vysoutěženými materiály, které se víceoborově testuje
- Možnost vyjádření pracovišť ke kvalitě materiálu

## Nevýhody:

- Velká pracnost testování
- Časová náročnost hodnocení
- Větší množství vzorků – dodavatelé mohou požadovat náhradu

# ZÁVĚR

- Přínos pro novou dimenzi testování – ověření nakupovaných materiálů v praxi a snížení ekonomických nákladů na materiál – menší spotřeba – pokud je materiál kvalitní
- Možnost dát více % na kvalitu

# KVALITATIVNĚ NEJLEPŠÍ SAVOST

**Děkuji za pozornost**

